


SERIE : ELECTRONIC	REVISIONE
Art. 30501/0HEL - Bocca erogazione ALTA con sistema elettronico a campo magnetico	00 DEL 2022

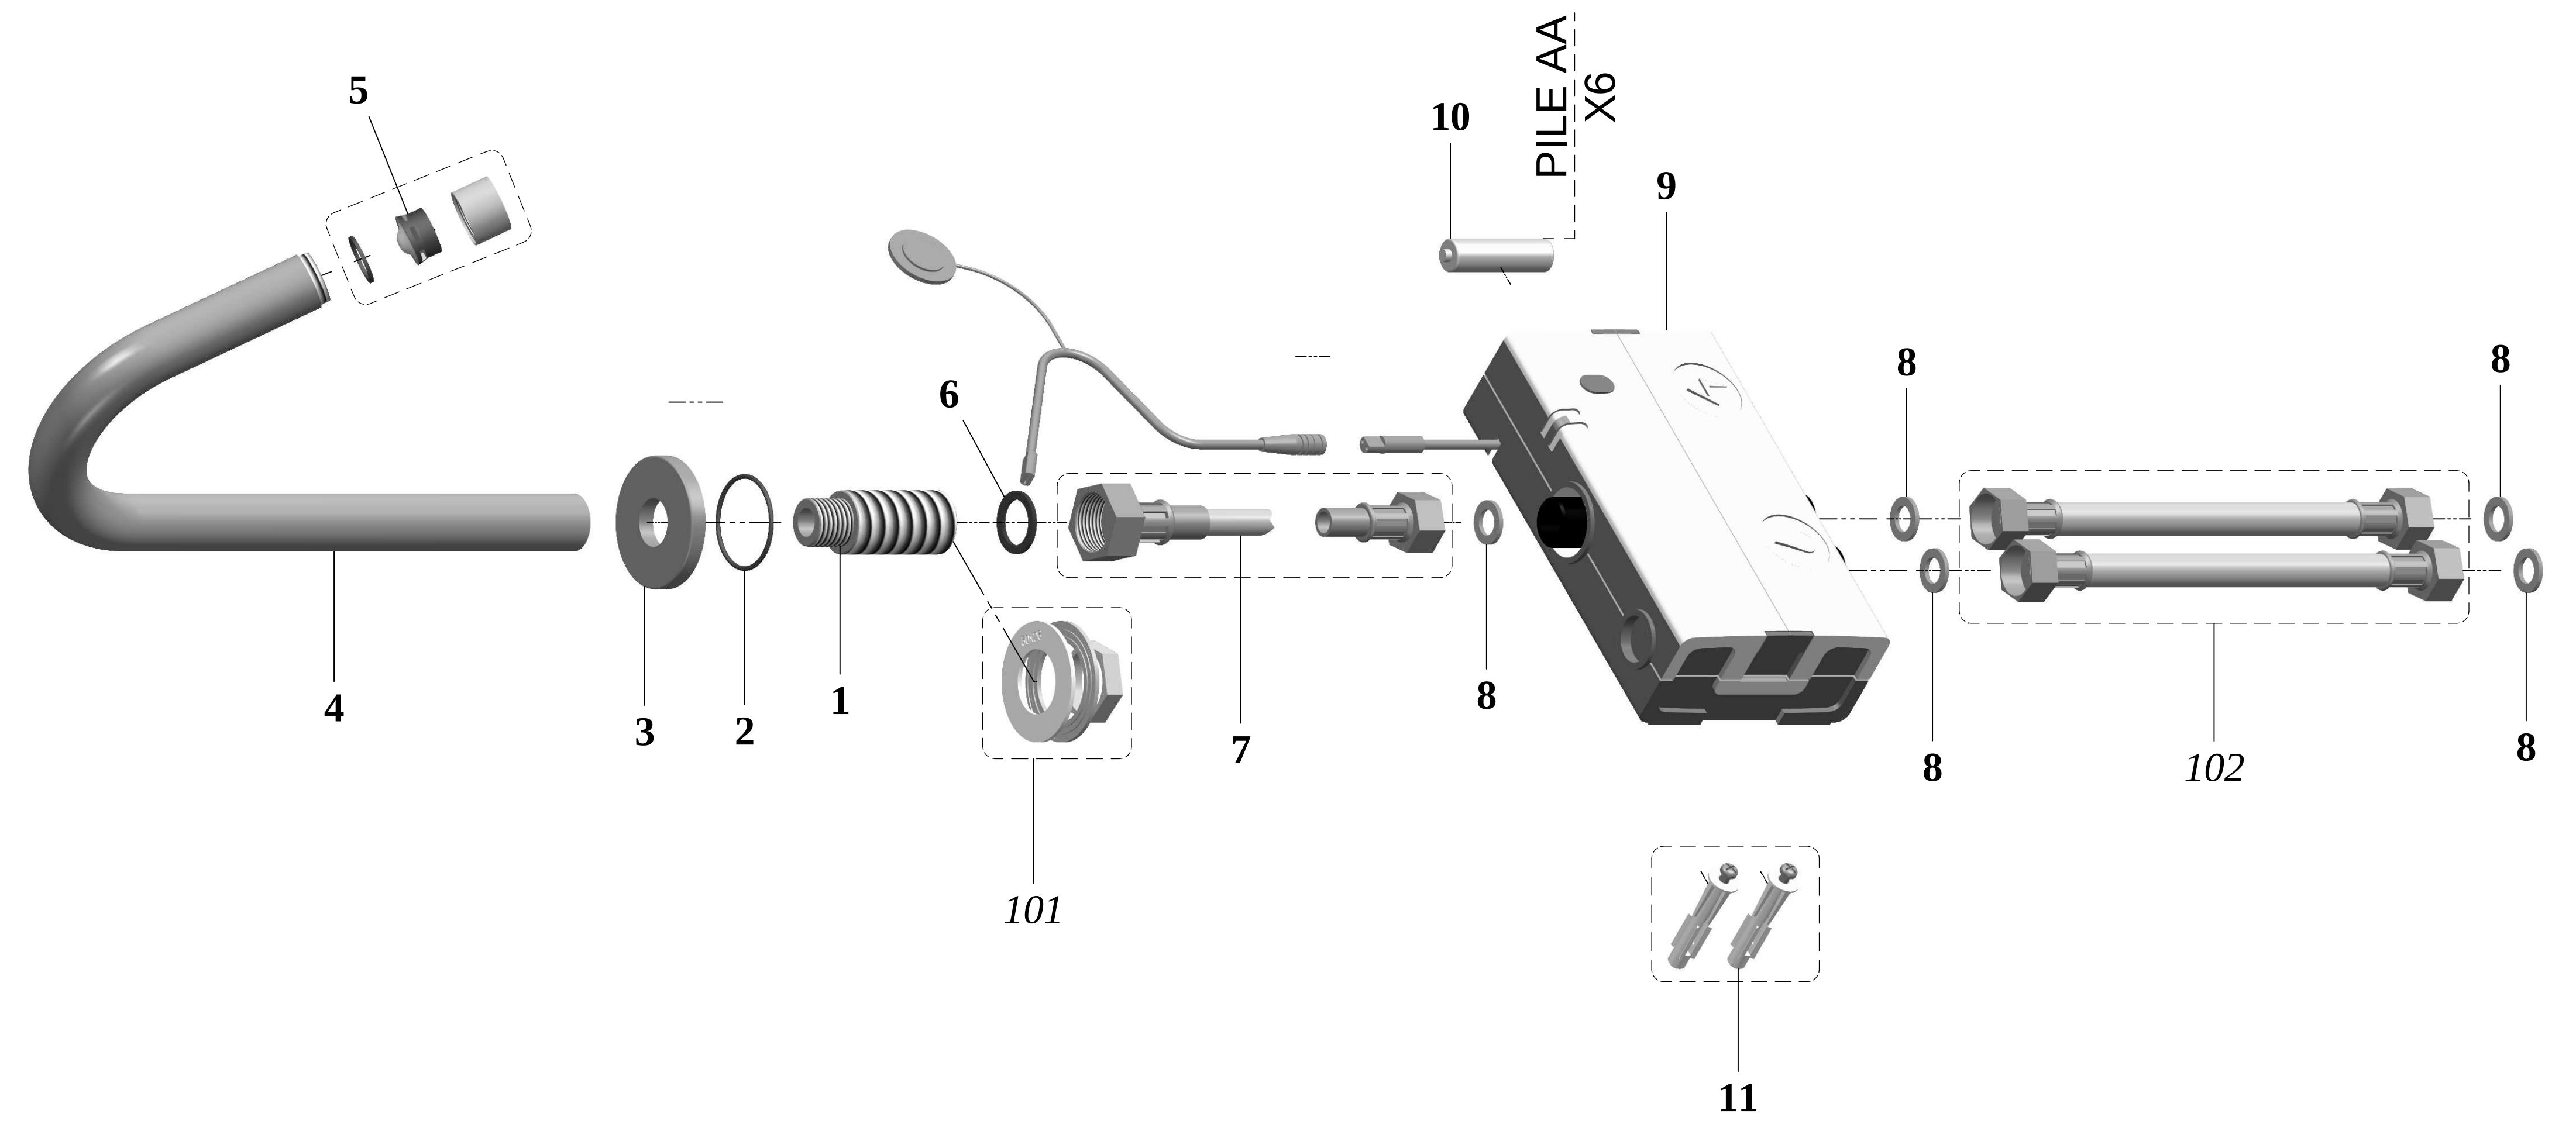

Uff. tecnico Uff.Acquisti Produzione.....